

平成 25 年 4 月 25 日

お得意様各位

三田理化工業株式会社
消耗品事業部

滅菌インジケータの変更について（お知らせ）

拝啓 時下、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素はラックーン製品をご愛顧いただきまして厚くお礼申し上げます。
さて、このたび弊社では下記の商品につきまして滅菌バッグをインジケータ
印字のないタイプに変更いたします。新滅菌バッグではインジケータをバッグ内に
挿入し、滅菌を行ないます。従って、お客様への滅菌完了表示は滅菌バッグ内にあ
るインジケータでご確認をいただけます。詳しくは添付の写真を御覧下さい。

なお、今回より使用します滅菌完了のインジケータは ISO11140-1:2006,CLASS4
に該当します。

今後ともラックーン製品を宜しく申し上げます。

敬具

記


滅菌バッグ変更商品：

ディスポ哺乳瓶 100ml 広口、200ml 広口

YRキャップ


以上

滅菌バッグの変更に伴う滅菌完了のインジケータ変更

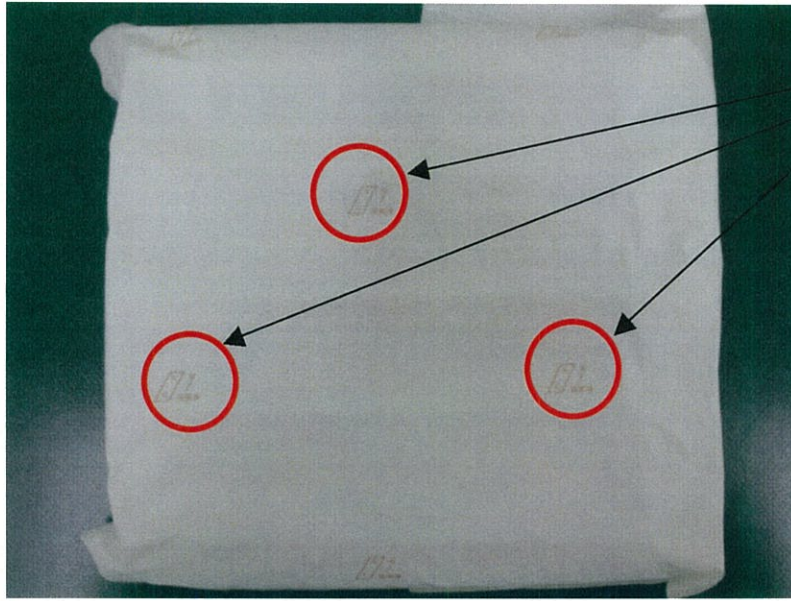

滅菌バッグに印字された
マークが茶に変色すれば
滅菌完了

従来の滅菌バッグ

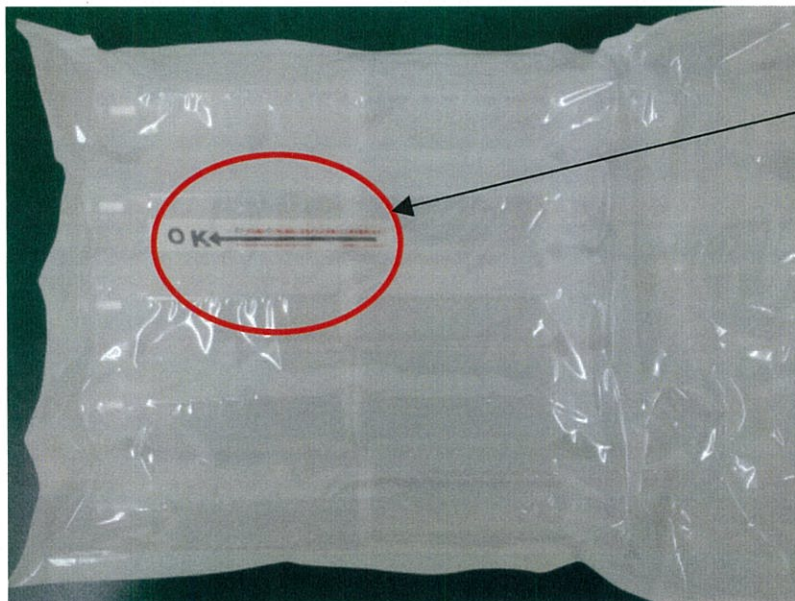

Kと⇒がOと同様に
黒く変色すれば
滅菌完了です。

新滅菌バッグとインジケータ